

KARTA TECHNICZNA


ŚCIEŻKA ZDROWIA 3

Numer katalogowy: 81283


Grupa wiekowa:	3 do 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	1,50 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.):	10,51 x 9,59 x 2,77 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.):	13,36 x 12,41 m



Wymiary urządzenia

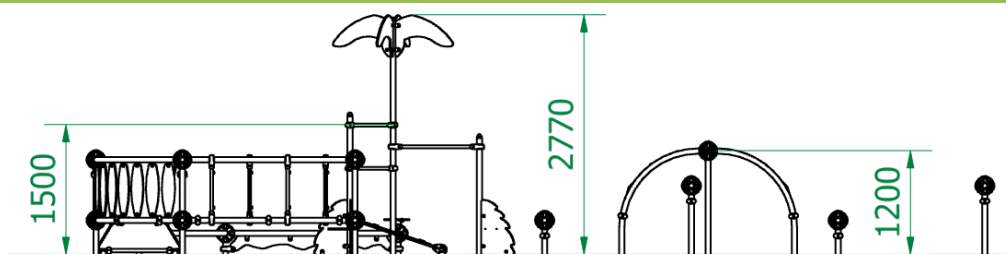

Wymiary powierzchni zderzenia

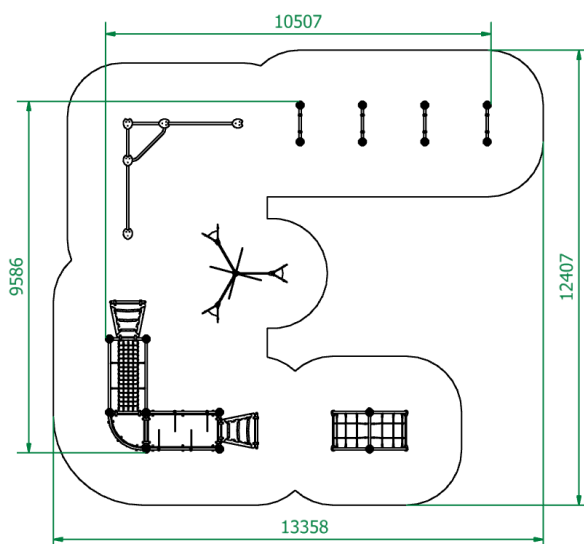

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Drań, gleba (z wyłączeniem drążków do akrobacji oraz łąki linowego)
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej), łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. Konstrukcja nośna nie jest spawana, lecz usztywniona łącznikami kulowymi o średnicy 200mm, wykonanymi z tworzywa sztucznego o bardzo wysokiej jakości.
- Jednowarstwowe oraz trójwarstwowe płyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 mm.
- Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej.
- Liny $\varnothing 16$ polipropylenowe, z rdzeniem stalowym.
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.